

Oberteil 150x36 mm - messingfarben eloxiert




DIN 16 185 B
DIN 16 186 S

Bestell-Beispiel	VB	2	64	1	1	063	2	1
Thermometerausführung								
gerade	VB							
Winkel 90°	HB							
Winkel 135°	SB							
Tauchrohrtyp								
		2						
Meßbereiche								
	-60 + 40°C	=64						
	-30 + 50°C	=35						
	0 + 60°C	=06						
	0 + 100°C	=10						
	0 + 120°C	=12						
	0 + 160°C	=16						
	0 + 200°C	=20						
	0 + 300°C	=30						
	0 + 400°C	=40						
	0 + 500°C	=50						
	0 + 600°C	=60						
Teilung								
	Celsius (°C)			1				
	Celsius + Fahrenheit (°C + F)			2				
Thermometrische Flüssigkeitsfüllung								
	blaue Füllung Standard für Meßbereiche bis +200°C (-60 bis +40°C rote Füllung)			Fü=1				
	über +200 °C Quecksilber			Hg=2				
Tauchrohreinbaulängen								
	Maß l ₁ in mm		63 =	063				
			100 =	100				
			160 =	160				
			250 =	250				
			400 =	400				
Einschraubgewinde								
			G 1/2 A / SW 27	2				
			M 20x1,5 / SW 27	7				

Tauchrohrwerkstoffe:		Messing (Sechskant Ms 58/Rohr SoMs 76 oder Ms 63), hart gelötet, bzw. bis Tauchrohrlänge l ₁ =63, G½A aus Ms 58 Vollmaterial nach unserer Wahl möglich.	1
		Stahl (Sechskant 9SMnPb28K/Rohr St 35, eingeschweißt)	2
		Edelstahl 1.4571 (Sechskant und Rohr)	3
		Sondermessing (Sechskant SoMs59/ Rohr SoMs 76)	4
		CuNi30Fe (Sechskant und Rohr)	5

Bei allen Winkelthermometern <90° ist das Tauchrohr durch einen Rillenzapfen mit dem Oberteil verbunden. Diese Verbindung wird durch eine gehärtete Feststellschraube gesichert.

Vorteil: Einfache Montage; Tauchrohr kann getrennt vom Oberteil montiert werden; kein Drehen des Oberteils bei der Montage erforderlich.

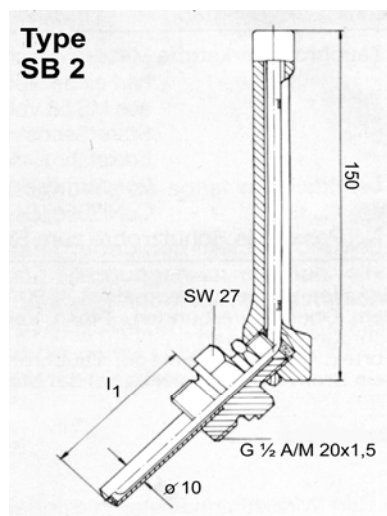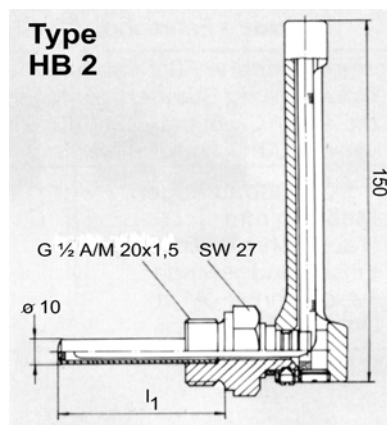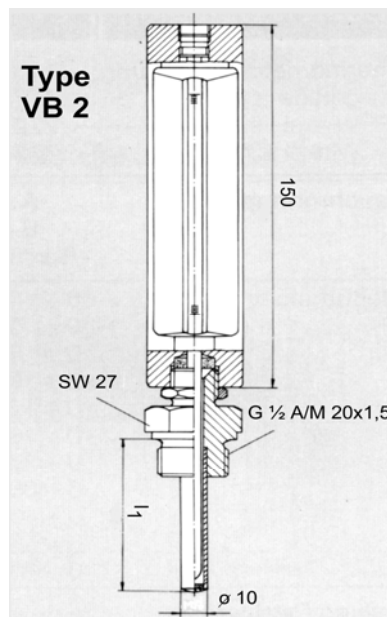

Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com



Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.com

